

Código de Laboratorio: 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación				Desempeño	
<b>Envío</b>	: Envío 1 de 2	<b>N° Evaluación</b>	: 31	Satisfactorio	IZI <= 2.0
<b>Fecha Envío</b>	: 11 de Mayo de 2021	<b>Fecha Entrega Informe</b>	: 11 de Junio de 2021	Cuestionable	2.0 < IZI < 3.0
<b>Tipo de Muestra</b>	: Hemolizado de Glóbulos Rojos Humanos	<b>Versión del Informe</b>	: V 0	Insatisfactorio	IZI >= 3.0

Equipamiento Utilizado en Material de Control HbA1c31				
Analito	Grupo	Equipo	Marca	Modelo
Hemoglobina Glicada	54	Autoanalizadores	Tosoh	G7
<b>Método :</b> HPLC				

Resultados del Material de Control HbA1c31											
Analito	Resultado	Unidad	Resumen							Desempeño	Clasificado en
			n	Xr	Sr	CVr	U(x)	D%	Zscore		
Hemoglobina Glicada	9,9	%	55	9,80	0,35	3,61	0,06	0,99	0,27	Satisfactorio	Equipamiento

Resultados del Material de Control HbA1c31											
Analito	Resultado	Unidad	n	Xr	Sr	CVr	U(x)	D%	Zscore	Análisis por	Desempeño
Hemoglobina Glicada	9,9	%	55	9,80	0,35	3,61	0,06	0,99	<b>0,27</b>	Equipamiento	Satisfactorio
Hemoglobina Glicada	9,9	%	155	9,64	0,29	3,05	0,03	2,73	0,89	Metodología	
Hemoglobina Glicada	9,9	%	358	9,50	0,40	4,19	0,03	4,24	1,01	Analito	


n=Número de laboratorios evaluados Xr=Media robusta Sr=Desviación estándar robusta CVr=Coficiente de variación robusto U(x)=Incertidumbre D%=Desvío relativo porcentual (c)=Valor corregido para Sr y ZScore

Código de Laboratorio: 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

**Identificación de la Evaluación**

<b>Envío</b>	: Envío 1 de 2	<b>N° Evaluación</b>	: 31
<b>Fecha Envío</b>	: 11 de Mayo de 2021	<b>Fecha Entrega Informe</b>	: 11 de Junio de 2021
<b>Tipo de Muestra</b>	: Hemolizado de Glóbulos Rojos Humanos	<b>Versión del Informe</b>	: V 0

**Gráficos**

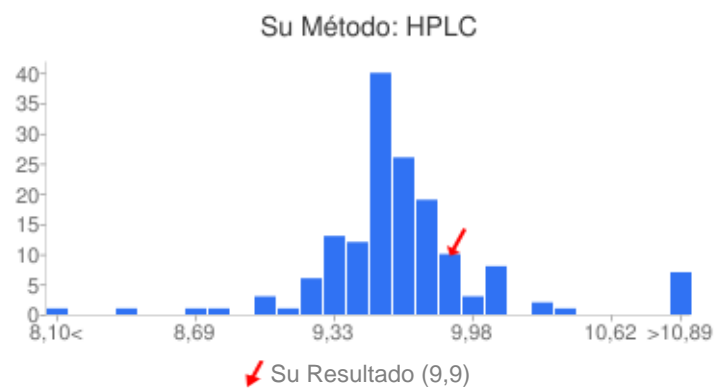

\* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.


Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Código de Laboratorio: 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

### Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 31
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 11 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Hemolizado de Glóbulos Rojos Humanos	Versión del Informe	: V 0

### Gráficos Z Score Históricos

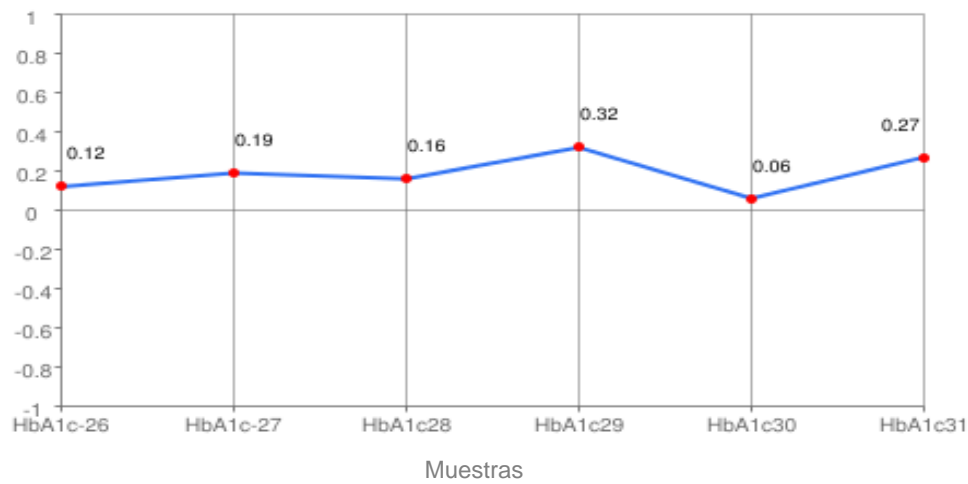

Código de Laboratorio: 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

### Identificación de la Evaluación

**Envío** : Envío 1 de 2  
**Fecha Envío** : 11 de Mayo de 2021  
**Tipo de Muestra** : Hemolizado de Glóbulos Rojos Humanos  
**N° Evaluación** : 31  
**Fecha Entrega Informe** : 11 de Junio de 2021  
**Versión del Informe** : V 0

### Desempeño Histórico

**SRZ:** Evaluación del desempeño histórico del Laboratorio, y se calcula a partir del resultado de las últimas 6 evaluaciones.

Analitos	SRZ	Desempeño Histórico
Hemoglobina Glicada	0,46	Satisfactorio

Criterios para Desempeño Histórico:  $|SRZ| \leq 2$  Satisfactorio;  $2 < |SRZ| < 3$  Cuestionable y  $|SRZ| \geq 3$  Insatisfactorio. Donde  $|SRZ| =$  Valor absoluto de SRZ



# PEEC

## PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD Informe de Evaluación de Desempeño Subprograma: Evaluación de Hemoglobina Glicada



Código de Laboratorio: 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

### Identificación de la Evaluación


Envío	: Envío 1 de 2	N° Evaluación	: 31
Fecha Envío	: 11 de Mayo de 2021	Fecha Entrega Informe	: 11 de Junio de 2021
Tipo de Muestra	: Hemolizado de Glóbulos Rojos Humanos	Versión del Informe	: V 0

### Observaciones

Específicas :

Generales :

*La información contenida en este informe se considera confidencial, salvo las contempladas en la ley vigente.*



**Autorizado por:** BQ. RICHARD PINO CÓRTEZ  
ENCARGADO DE CALIDAD SECCION QUIMICA CLINICA