

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 10
Fecha Envío	: 22 de Junio de 2021	Fecha Entrega Informe	: 27 de Julio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 0

Equipamiento Utilizado en Material de Control: H-10 - Hormonas

Analito	Grupo	Equipo	Marca	Modelo	Método
Cortisol	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Quimioluminiscencia
Estradiol	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Quimioluminiscencia
Ferritina	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Quimioluminiscencia
FSH	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Quimioluminiscencia
hCG	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Quimioluminiscencia
Insulina	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Quimioluminiscencia
LH	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Quimioluminiscencia
Prolactina	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Quimioluminiscencia
T3 Total	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Quimioluminiscencia
T4 Libre	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Quimioluminiscencia
T4 Total	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Quimioluminiscencia
TSH	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Quimioluminiscencia

Equipamiento Utilizado en Material de Control: H-10 - Vitaminas

Analito	Grupo	Equipo	Marca	Modelo	Método
Folato	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Quimioluminiscencia
Vitamina B12	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	Vitros 5600	Quimioluminiscencia

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación	Desempeño
---------------------------------	-----------

Envío : Envío 1 de 2	N° Evaluación : 10	Satisfactorio IZI <= 2.0
Fecha Envío : 22 de Junio de 2021	Fecha Entrega Informe : 27 de Julio de 2021	Cuestionable 2.0 < IZI < 3.0
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0	Insatisfactorio IZI >= 3.0

Resultados del Material de Control Resumen: H-10 - Hormonas											
Analito	Resultado	Unidad	Resumen							Desempeño	Clasificado en
			n	Xr	Sr	CVr	U(x)	D%	Zscore		
Cortisol	21,57	µg / dL	16	21,828	1,569(c)	6,86	0,47	-1,18	-0,16(c)	Satisfactorio	Equipamiento
Estradiol	343,10	pg / mL	27	316,904	21,292	6,72	5,12	8,27	1,23	Satisfactorio	Equipamiento
Ferritina	63,13	ng / mL	27	61,917	2,935	4,74	0,71	1,96	0,41	Satisfactorio	Equipamiento
FSH	21,53	mIU / mL	33	22,253	0,858	3,86	0,19	-3,25	-0,84	Satisfactorio	Equipamiento
hCG	39,77	mIU / mL	45	37,530	2,282	6,08	0,43	5,97	0,98	Satisfactorio	Equipamiento
Insulina	14,30	µIU / mL	39	15,569	0,895	5,75	0,18	-8,15	-1,42	Satisfactorio	Equipamiento
LH	48,30	mIU / mL	27	46,042	1,932	4,20	0,46	4,90	1,17	Satisfactorio	Equipamiento
Prolactina	26,53	ng / mL	25	25,671	0,841	3,28	0,21	3,35	1,02	Satisfactorio	Equipamiento
T3 Total	2,72	ng / mL	42	2,752	0,096	3,50	0,02	-1,17	-0,33	Satisfactorio	Equipamiento
T4 Libre	6,37	ng / dL	46	6,201	0,252	4,07	0,05	2,73	0,67	Satisfactorio	Equipamiento
T4 Total	10,90	µg / dL	44	10,814	0,740	6,84	0,14	0,80	0,12	Satisfactorio	Equipamiento
TSH	3,06	µIU / mL	46	2,922	0,159	5,45	0,03	4,73	0,87	Satisfactorio	Equipamiento

n=Número de laboratorios evaluados Xr=Media robusta Sr=Desviación estándar robusta CVr=Coefficiente de variación robusto U(x)=Incertidumbre D%=Desvío relativo porcentual (c)=Valor corregido para Sr y ZScore

Resultados del Material de Control Resumen: H-10 - Vitaminas											
Analito	Resultado	Unidad	Resumen							Desempeño	Clasificado en
			n	Xr	Sr	CVr	U(x)	D%	Zscore		
Folato	3,11	ng / mL	11	3,875	0,586(c)	14,16	0,21	-19,75	-1,31(c)	Satisfactorio	Equipamiento
Vitamina B12	593,33	pg / mL	24	629,239	45,997	7,31	11,74	-5,71	-0,78	Satisfactorio	Equipamiento

n=Número de laboratorios evaluados Xr=Media robusta Sr=Desviación estándar robusta CVr=Coefficiente de variación robusto U(x)=Incertidumbre D%=Desvío relativo porcentual (c)=Valor corregido para Sr y ZScore

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 1 de 2 N° Evaluación : 10
 Fecha Envío : 22 de Junio de 2021 Fecha Entrega Informe : 27 de Julio de 2021
 Tipo de Muestra : Suero Liofilizado Versión del Informe : V 0

Resultados del Material de Control Equipamiento: H-10 - Hormonas evaluadas por valor consenso (estadística robusta Algoritmo A)										
Analito	Resultado	Unidad	Análisis por Equipamiento							Desempeño
			n	Xr	Sr	CVr	U(x)	D%	Zscore	
Cortisol	21,57	µg / dL	16	21,828	1,569(c)	6,86	0,47	-1,18	-0,16(c)	Satisfactorio
Estradiol	343,10	pg / mL	27	316,904	21,292	6,72	5,12	8,27	1,23	Satisfactorio
Ferritina	63,13	ng / mL	27	61,917	2,935	4,74	0,71	1,96	0,41	Satisfactorio
FSH	21,53	mIU / mL	33	22,253	0,858	3,86	0,19	-3,25	-0,84	Satisfactorio
hCG	39,77	mIU / mL	45	37,530	2,282	6,08	0,43	5,97	0,98	Satisfactorio
Insulina	14,30	µIU / mL	39	15,569	0,895	5,75	0,18	-8,15	-1,42	Satisfactorio
LH	48,30	mIU / mL	27	46,042	1,932	4,20	0,46	4,90	1,17	Satisfactorio
Prolactina	26,53	ng / mL	25	25,671	0,841	3,28	0,21	3,35	1,02	Satisfactorio
T3 Total	2,72	ng / mL	42	2,752	0,096	3,50	0,02	-1,17	-0,33	Satisfactorio
T4 Libre	6,37	ng / dL	46	6,201	0,252	4,07	0,05	2,73	0,67	Satisfactorio
T4 Total	10,90	µg / dL	44	10,814	0,740	6,84	0,14	0,80	0,12	Satisfactorio
TSH	3,06	µIU / mL	46	2,922	0,159	5,45	0,03	4,73	0,87	Satisfactorio

n=Número de laboratorios evaluados Xr=Media robusta Sr=Desviación estándar robusta CVr=Coefficiente de variación robusto U(x)=Incertidumbre D%=Desvío relativo porcentual
 (c)=Valor corregido para Sr y ZScore

Resultados del Material de Control Equipamiento: H-10 - Vitaminas evaluadas por valor consenso (estadística robusta Algoritmo A)										
Analito	Resultado	Unidad	Análisis por Equipamiento							Desempeño
			n	Xr	Sr	CVr	U(x)	D%	Zscore	
Folato	3,11	ng / mL	11	3,875	0,586(c)	14,16	0,21	-19,75	-1,31(c)	Satisfactorio
Vitamina B12	593,33	pg / mL	24	629,239	45,997	7,31	11,74	-5,71	-0,78	Satisfactorio

n=Número de laboratorios evaluados Xr=Media robusta Sr=Desviación estándar robusta CVr=Coefficiente de variación robusto U(x)=Incertidumbre D%=Desvío relativo porcentual
 (c)=Valor corregido para Sr y ZScore

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación	Desempeño
---------------------------------	-----------

Envío : Envío 1 de 2	Nº Evaluación : 10	Satisfactorio IZI <= 2.0
Fecha Envío : 22 de Junio de 2021	Fecha Entrega Informe : 27 de Julio de 2021	Cuestionable 2.0 < IZI < 3.0
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0	Insatisfactorio IZI >= 3.0

Resultados del Material de Control Metodología: H-10 - Hormonas evaluadas por valor consenso (estadística robusta Algoritmo A)										
Analito	Resultado	Unidad	Análisis por Metodología							Desempeño
			n	Xr	Sr	CVr	U(x)	D%	Zscore	
Cortisol	21,57	µg / dL	59	24,479	4,253	17,37	0,69	-11,88	-0,68	
Estradiol	343,10	pg / mL	98	315,840	56,113	17,77	7,09	8,63	0,49	
Ferritina	63,13	ng / mL	97	82,748	21,145	25,55	2,68	-23,71	-0,93	
FSH	21,53	mIU / mL	124	29,022	6,441	22,19	0,72	-25,81	-1,16	
hCG	39,77	mIU / mL	159	28,646	8,350	29,15	0,83	38,83	1,33	
Insulina	14,30	µIU / mL	170	16,798	2,073	12,34	0,20	-14,87	-1,21	
LH	48,30	mIU / mL	109	37,132	9,206	24,79	1,10	30,08	1,21	
Prolactina	26,53	ng / mL	99	27,388	2,998	10,95	0,38	-3,13	-0,29	
T3 Total	2,72	ng / mL	185	2,404	0,513	21,35	0,05	13,14	0,62	
T4 Libre	6,37	ng / dL	215	3,227	0,993	30,78	0,08	97,39	3,16	
T4 Total	10,90	µg / dL	190	11,249	1,026	9,12	0,09	-3,10	-0,34	
TSH	3,06	µIU / mL	215	2,823	0,414	14,67	0,04	8,38	0,57	

n=Número de laboratorios evaluados Xr=Media robusta Sr=Desviación estándar robusta CVr=Coefficiente de variación robusto U(x)=Incertidumbre D%=Desvío relativo porcentual (c)=Valor corregido para Sr y ZScore

Resultados del Material de Control Metodología: H-10 - Vitaminas evaluadas por valor consenso (estadística robusta Algoritmo A)										
Analito	Resultado	Unidad	Análisis por Metodología							Desempeño
			n	Xr	Sr	CVr	U(x)	D%	Zscore	
Folato	3,11	ng / mL	30	9,256	5,758	62,21	1,31	-66,40	-1,07	
Vitamina B12	593,33	pg / mL	87	640,767	105,559	16,47	14,15	-7,40	-0,45	

n=Número de laboratorios evaluados Xr=Media robusta Sr=Desviación estándar robusta CVr=Coefficiente de variación robusto U(x)=Incertidumbre D%=Desvío relativo porcentual (c)=Valor corregido para Sr y ZScore

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación	Desempeño
---------------------------------	-----------

Envío : Envío 1 de 2	Nº Evaluación : 10	Satisfactorio IZI <= 2.0
Fecha Envío : 22 de Junio de 2021	Fecha Entrega Informe : 27 de Julio de 2021	Cuestionable 2.0 < IZI < 3.0
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0	Insatisfactorio IZI >= 3.0

Resultados del Material de Control Analito: H-10		Hormonas evaluadas por valor consenso (estadística robusta Algoritmo A)								Desempeño
Analito	Resultado	Unidad	Análisis por Analito							
			n	Xr	Sr	CVr	U(x)	D%	Zscore	
Cortisol	21,57	µg / dL	85	23,659	3,373	14,26	0,46	-8,83	-0,62	
Estradiol	343,10	pg / mL	132	305,385	59,755	19,57	6,50	12,35	0,63	
Ferritina	63,13	ng / mL	132	88,208	22,255	25,23	2,42	-28,43	-1,13	
FSH	21,53	mIU / mL	172	28,447	5,568	19,57	0,53	-24,32	-1,24	
hCG	39,77	mIU / mL	222	27,839	7,273	26,12	0,61	42,86	1,64	
Insulina	14,30	µIU / mL	242	16,946	1,865	11,01	0,15	-15,61	-1,42	
LH	48,30	mIU / mL	154	36,598	7,638	20,87	0,77	31,98	1,53	
Prolactina	26,53	ng / mL	136	27,935	2,951	10,56	0,32	-5,03	-0,48	
T3 Total	2,72	ng / mL	257	2,448	0,476	19,45	0,04	11,10	0,57	
T4 Libre	6,37	ng / dL	304	3,071	0,617	20,09	0,04	107,40	5,35	
T4 Total	10,90	µg / dL	260	11,034	1,083	9,82	0,08	-1,21	-0,12	
TSH	3,06	µIU / mL	310	2,789	0,349	12,52	0,02	9,71	0,78	

n = Número de laboratorios evaluados Xr = Media robusta Sr = Desviación estándar robusta CVr = Coeficiente de variación robusto U(x) = Incertidumbre D% = Desvío relativo porcentual

Resultados del Material de Control Analito: H-10		Vitaminas evaluadas por valor consenso (estadística robusta Algoritmo A)								Desempeño
Analito	Resultado	Unidad	Análisis por Analito							
			n	Xr	Sr	CVr	U(x)	D%	Zscore	
Folato	3,11	ng / mL	36	8,663	5,095	58,82	1,06	-64,10	-1,09	
Vitamina B12	593,33	pg / mL	113	638,301	90,722	14,21	10,67	-7,05	-0,50	



n = Número de laboratorios evaluados Xr = Media robusta Sr = Desviación estándar robusta CVr = Coeficiente de variación robusto U(x) = Incertidumbre D% = Desvío relativo porcentual

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 10
Fecha Envío	: 22 de Junio de 2021	Fecha Entrega Informe	: 27 de Julio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 0


Gráficos Analito : Cortisol

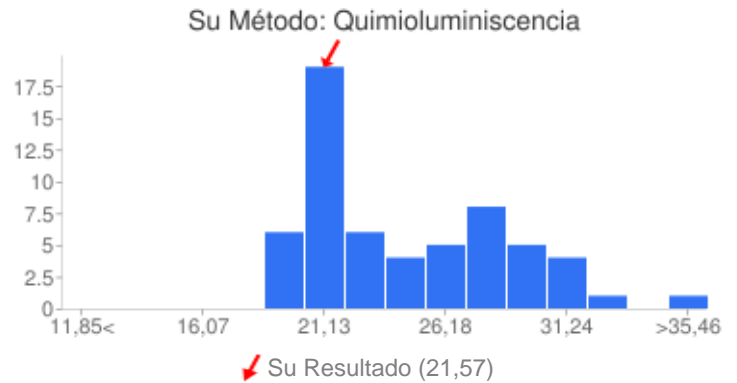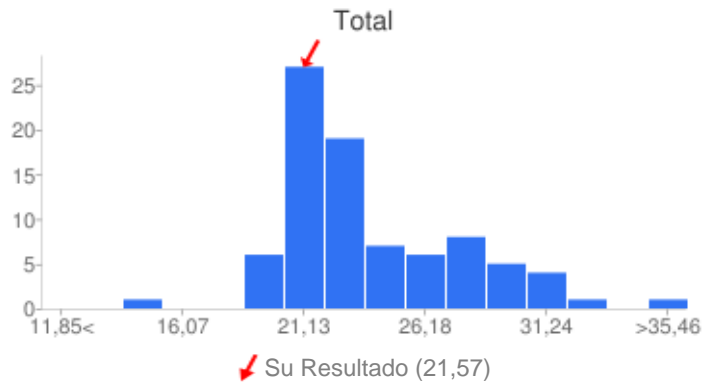

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Gráficos Z Score Históricos : Cortisol


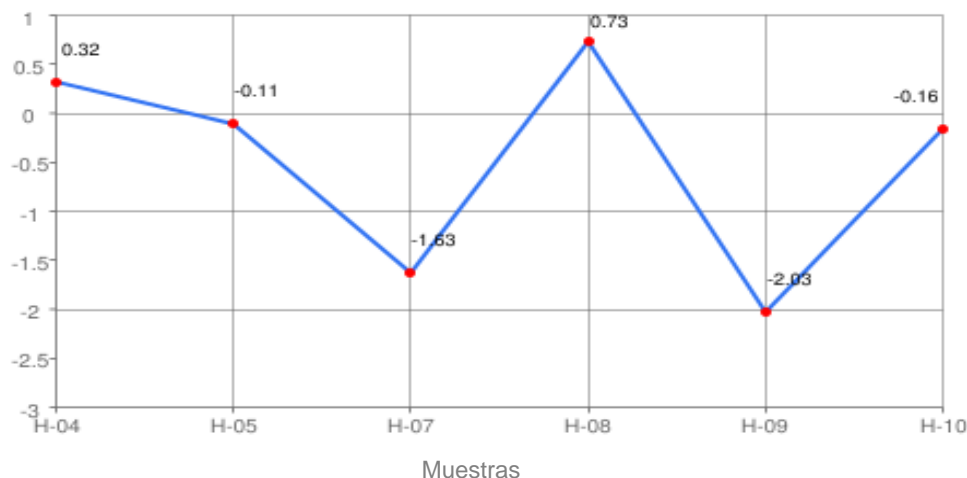


Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 1 de 2	Nº Evaluación : 10
Fecha Envío : 22 de Junio de 2021	Fecha Entrega Informe : 27 de Julio de 2021
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0


Gráficos Analito : Estradiol

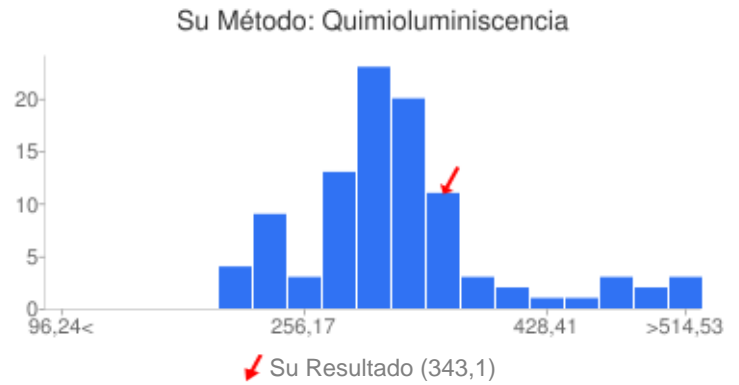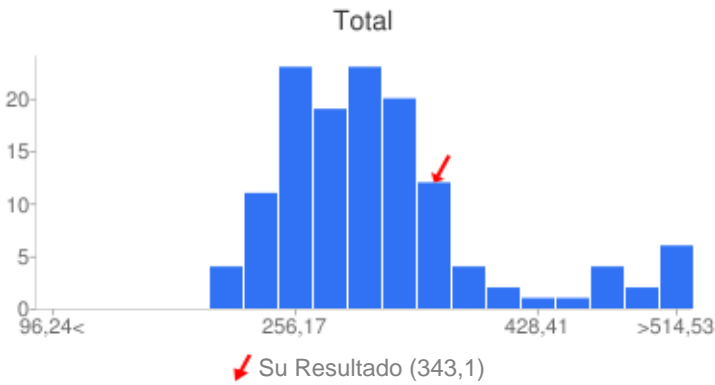

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Gráficos Z Score Históricos : Estradiol

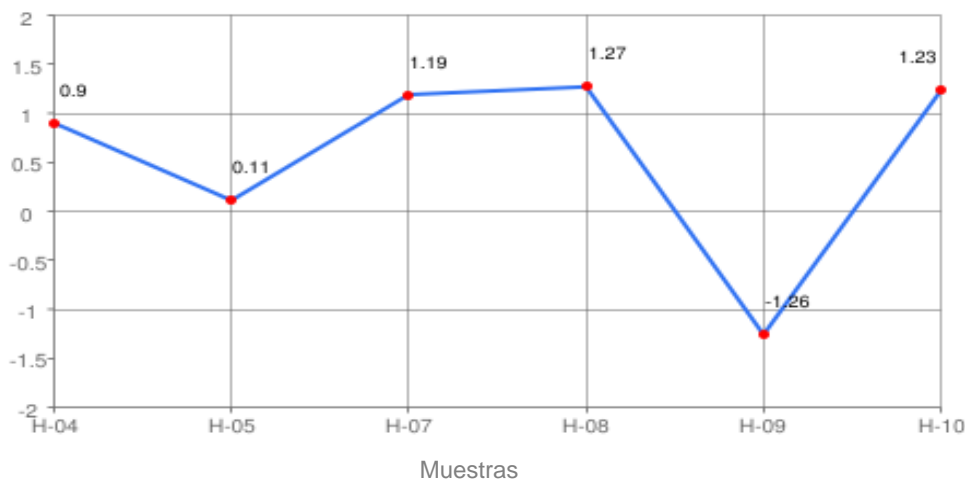


Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 10
Fecha Envío	: 22 de Junio de 2021	Fecha Entrega Informe	: 27 de Julio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 0


Gráficos Analito : Ferritina

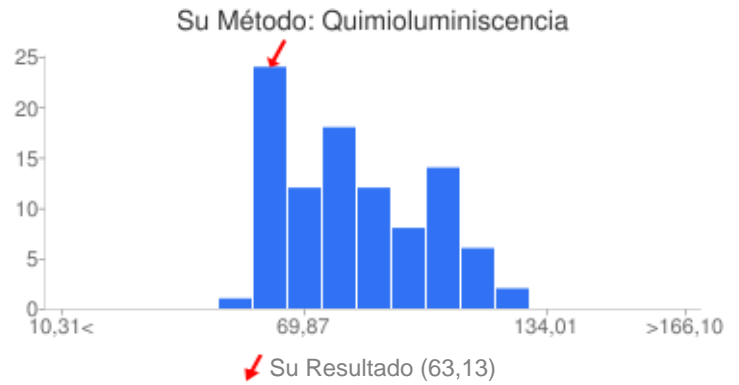

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Gráficos Z Score Históricos : Ferritina


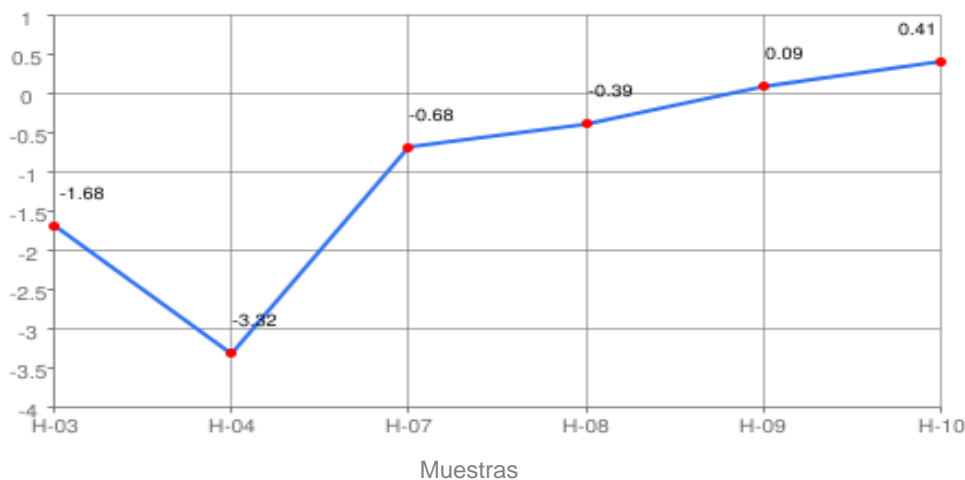


Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 1 de 2	N° Evaluación : 10
Fecha Envío : 22 de Junio de 2021	Fecha Entrega Informe : 27 de Julio de 2021
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0


Gráficos Analito : FSH

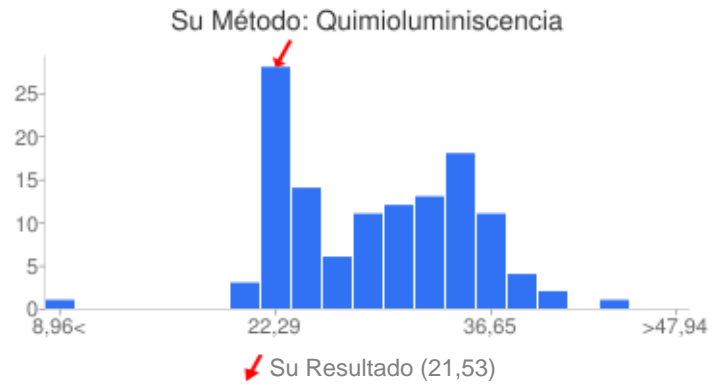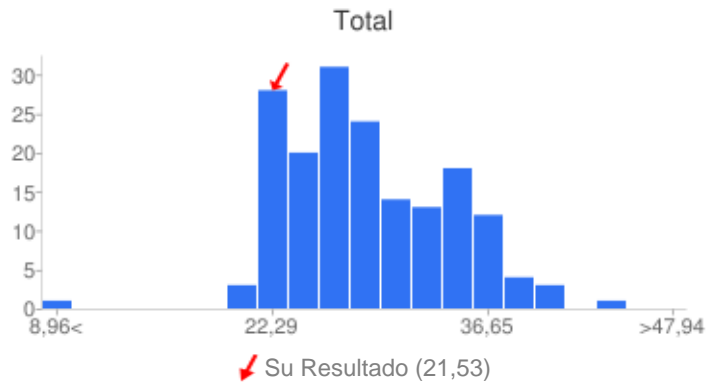

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Gráficos Z Score Históricos : FSH

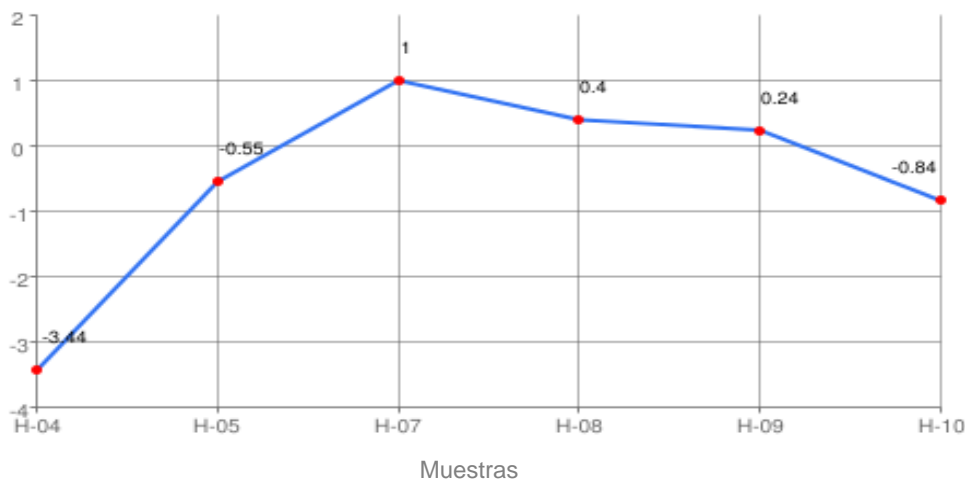

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 1 de 2	Nº Evaluación : 10
Fecha Envío : 22 de Junio de 2021	Fecha Entrega Informe : 27 de Julio de 2021
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0


Gráficos Analito : hCG



* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Gráficos Z Score Históricos : hCG

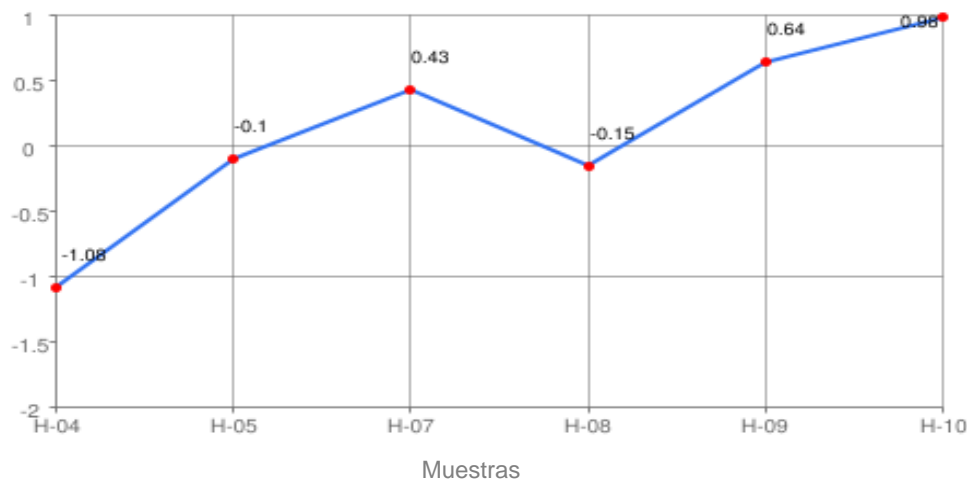

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 1 de 2	Nº Evaluación : 10
Fecha Envío : 22 de Junio de 2021	Fecha Entrega Informe : 27 de Julio de 2021
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0

Gráficos Analito : Insulina

Total



Su Método: Quimioluminiscencia




*Su Grupo Par: 10



* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Gráficos Z Score Históricos : Insulina

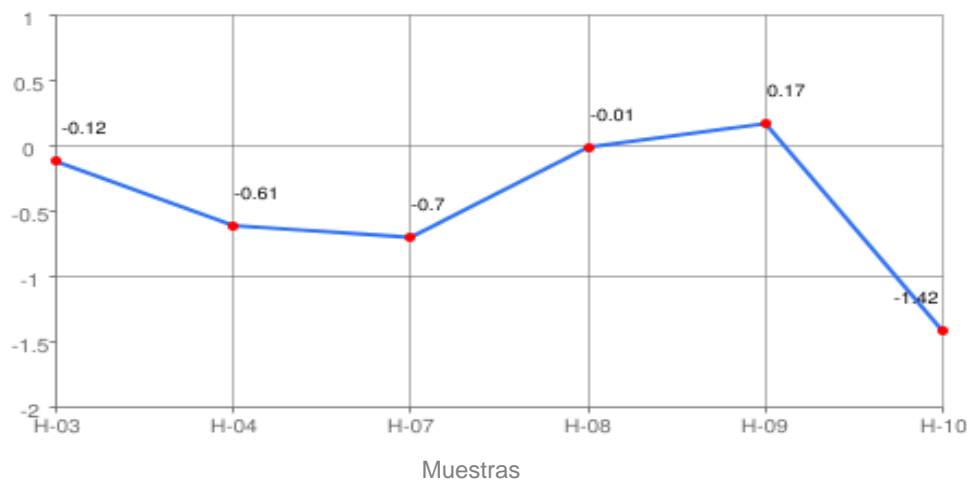


Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 1 de 2	Nº Evaluación : 10
Fecha Envío : 22 de Junio de 2021	Fecha Entrega Informe : 27 de Julio de 2021
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0


Gráficos Analito : LH

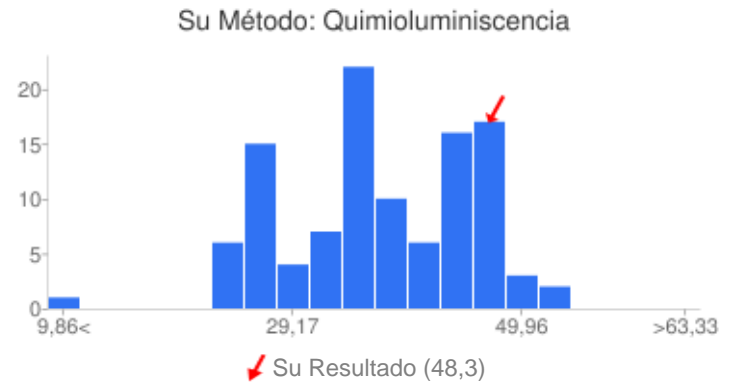

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Gráficos Z Score Históricos : LH

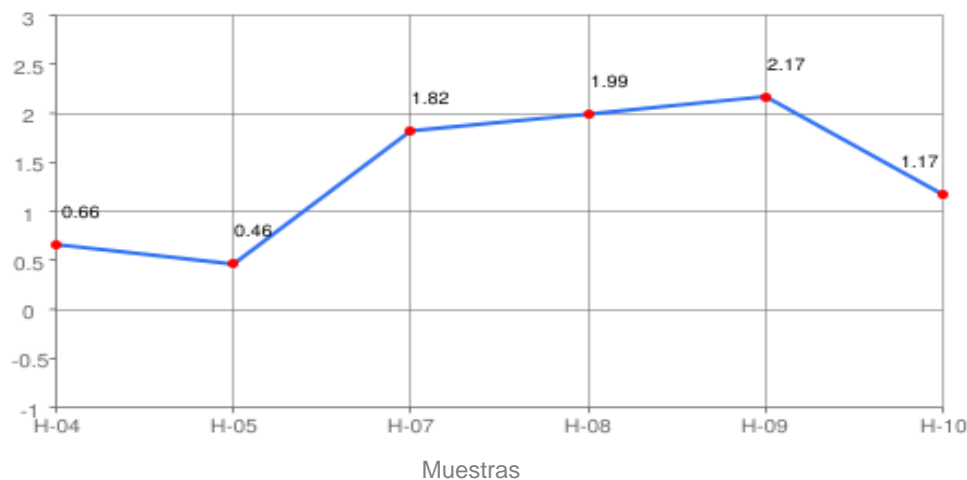


Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 1 de 2	Nº Evaluación : 10
Fecha Envío : 22 de Junio de 2021	Fecha Entrega Informe : 27 de Julio de 2021
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0


Gráficos Analito : Prolactina

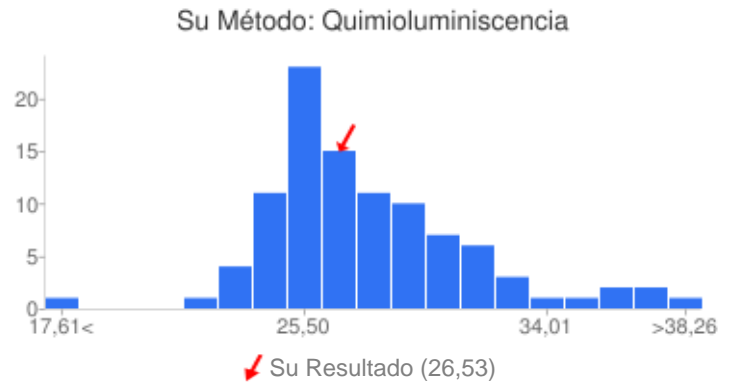

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Gráficos Z Score Históricos : Prolactina

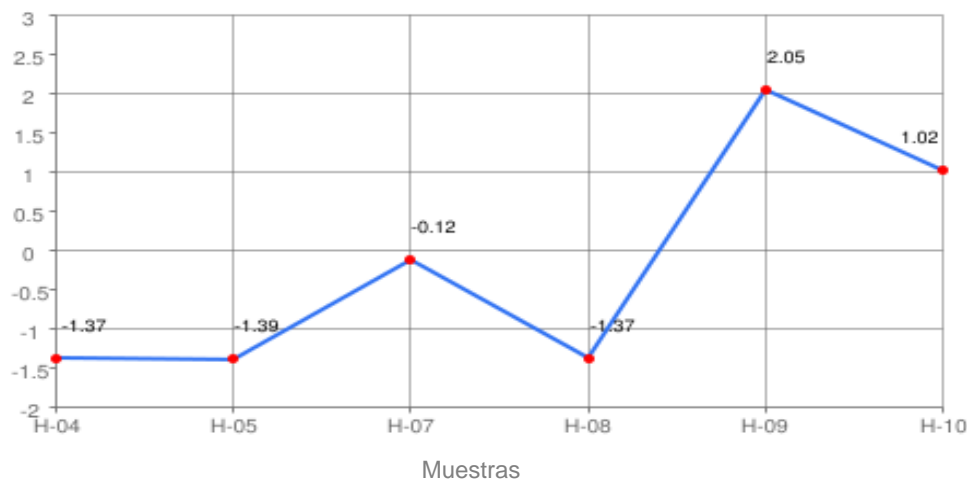


Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 1 de 2	Nº Evaluación : 10
Fecha Envío : 22 de Junio de 2021	Fecha Entrega Informe : 27 de Julio de 2021
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0


Gráficos Analito : T3 Total

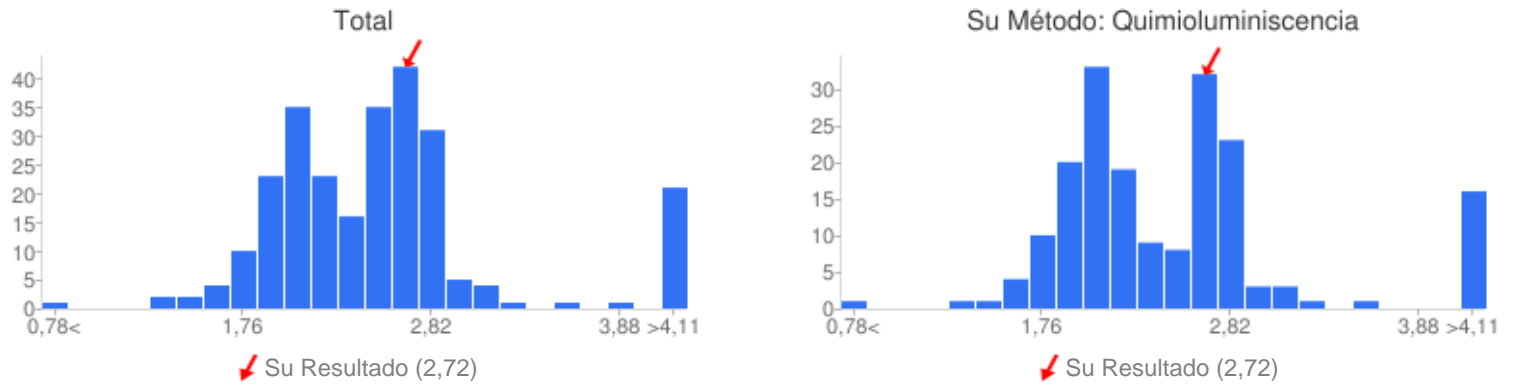

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Gráficos Z Score Históricos : T3 Total

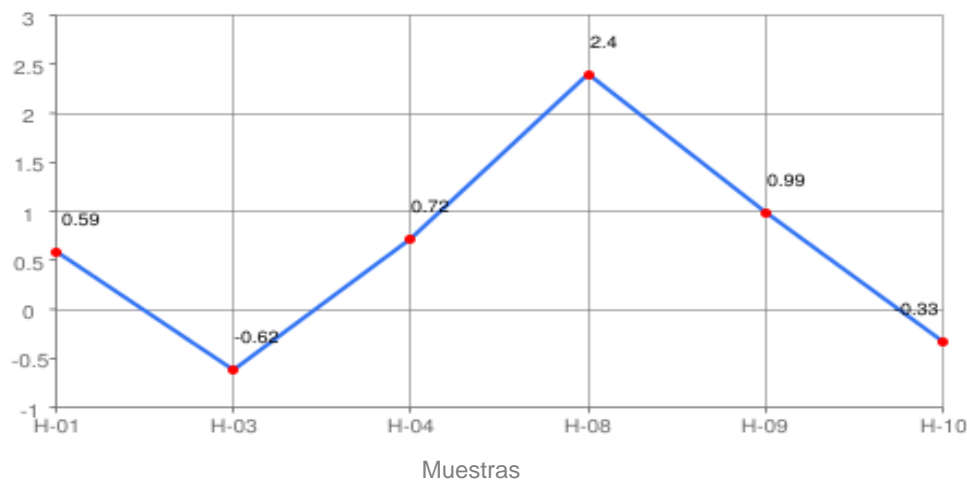


Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 1 de 2	Nº Evaluación : 10
Fecha Envío : 22 de Junio de 2021	Fecha Entrega Informe : 27 de Julio de 2021
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0


Gráficos Analito : T4 Libre

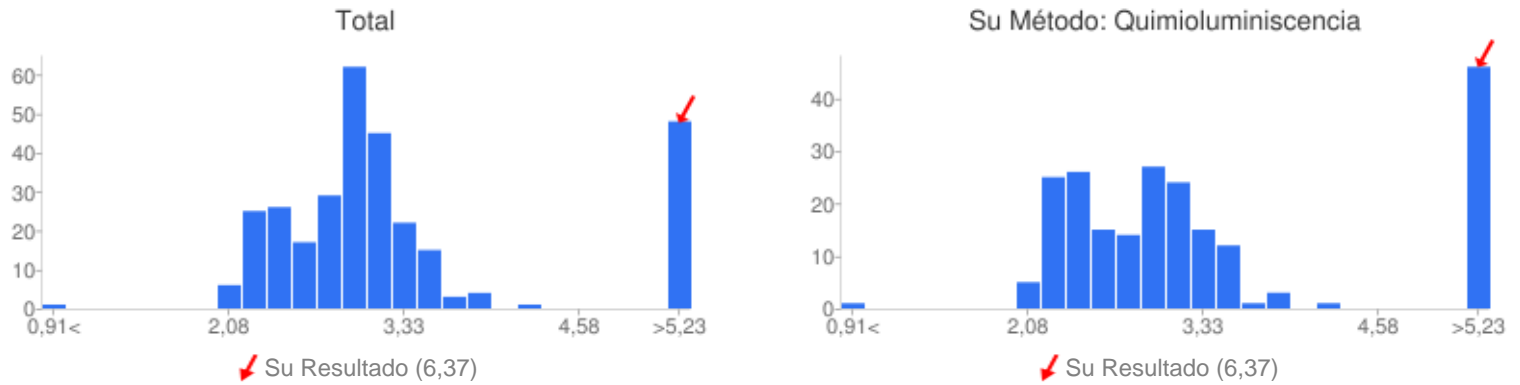

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Gráficos Z Score Históricos : T4 Libre

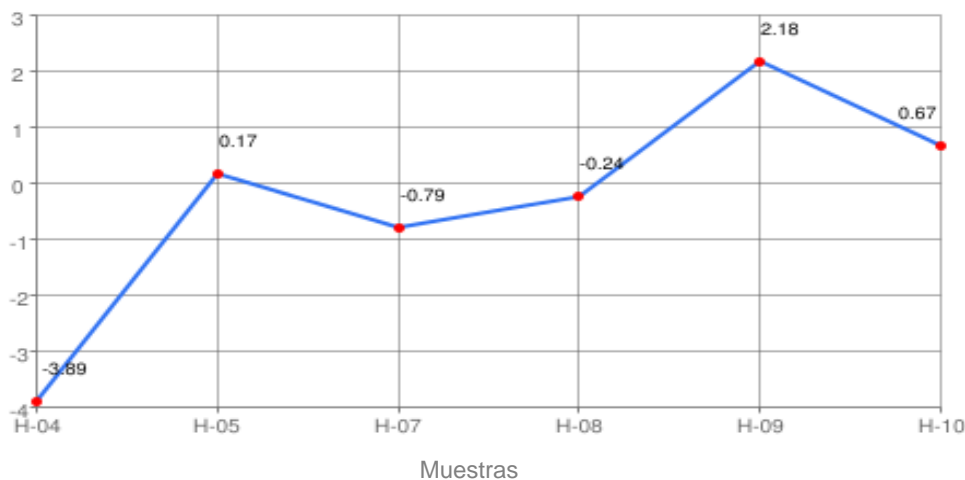

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 1 de 2	Nº Evaluación : 10
Fecha Envío : 22 de Junio de 2021	Fecha Entrega Informe : 27 de Julio de 2021
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0


Gráficos Analito : T4 Total



* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Gráficos Z Score Históricos : T4 Total

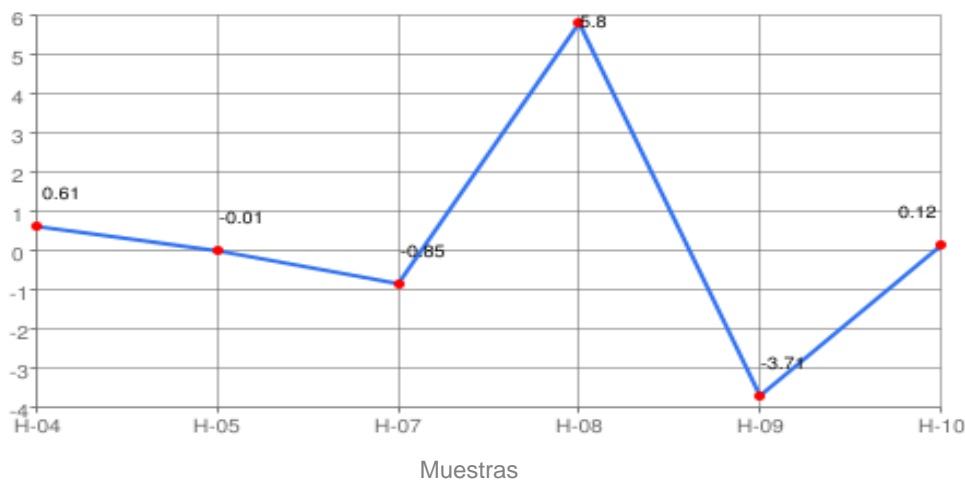


Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 1 de 2	Nº Evaluación : 10
Fecha Envío : 22 de Junio de 2021	Fecha Entrega Informe : 27 de Julio de 2021
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0


Gráficos Analito : TSH

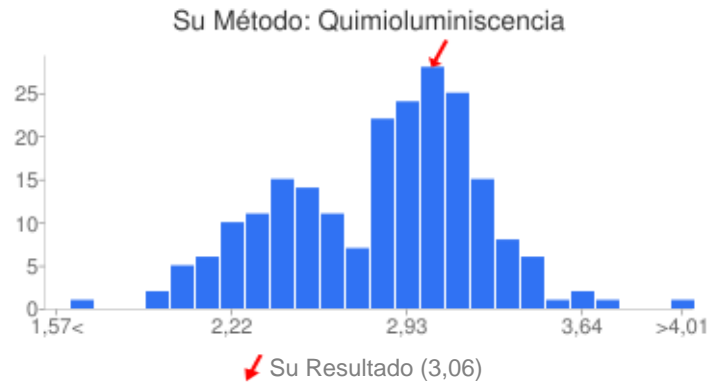

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Gráficos Z Score Históricos : TSH

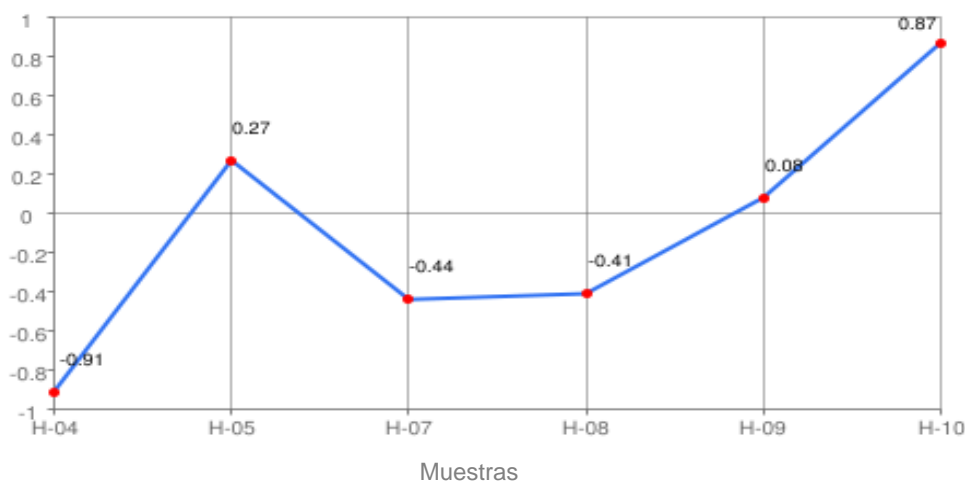

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 1 de 2	Nº Evaluación : 10
Fecha Envío : 22 de Junio de 2021	Fecha Entrega Informe : 27 de Julio de 2021
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0

Gráficos Analito : Folato



* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.



Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 1 de 2	N° Evaluación : 10
Fecha Envío : 22 de Junio de 2021	Fecha Entrega Informe : 27 de Julio de 2021
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0

Gráficos Analito : Vitamina B12

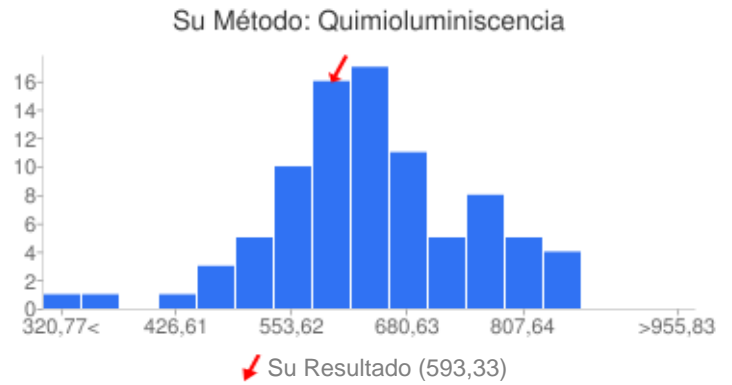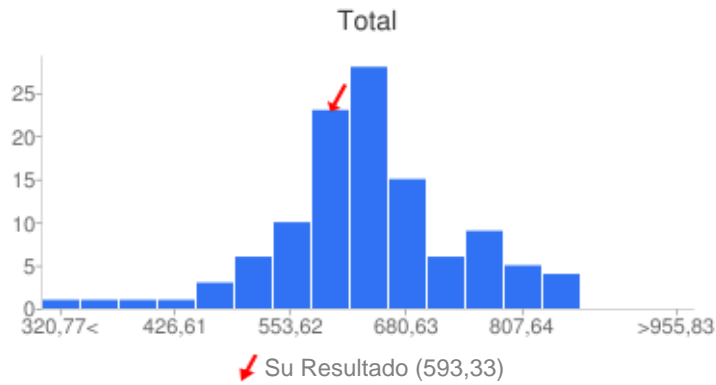

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación		Desempeño	
Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 10
Fecha Envío	: 22 de Junio de 2021	Fecha Entrega Informe	: 27 de Julio de 2021
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 0
		Satisfactorio	IZI <= 2.0
		Cuestionable	2.0 < IZI < 3.0
		Insatisfactorio	IZI >= 3.0

Desempeño Histórico

SRZ: Evaluación del desempeño histórico del Laboratorio, y se calcula a partir del resultado de las últimas 6 evaluaciones.

Hormonas	SRZ	Desempeño Histórico
Cortisol	-1,18	Satisfactorio
Estradiol	1,40	Satisfactorio
Ferritina		
FSH	-1,30	Satisfactorio
hCG	0,29	Satisfactorio
Hormona del crecimiento (hGH)		
Insulina		
LH	3,38	Insatisfactorio
Parathormona (PTH)		
Progesterona		
Prolactina	-0,48	Satisfactorio
T3 Total		
T4 Libre	-0,78	Satisfactorio
T4 Total	0,80	Satisfactorio
Testosterona		
TSH	-0,22	Satisfactorio

Vitaminas	SRZ	Desempeño Histórico
Folato		
Vitamina B12		
Vitamina D		

Criterios para Desempeño Histórico: | SRZ | <= 2 Satisfactorio; 2 < | SRZ | < 3 Cuestionable y | SRZ | >= 3 Insatisfactorio. Donde | SRZ | = Valor absoluto de SRZ

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación		Desempeño			
Envío	: Envío 1 de 2	Nº Evaluación	: 10	Satisfactorio	IZI <= 2.0
Fecha Envío	: 22 de Junio de 2021	Fecha Entrega Informe	: 27 de Julio de 2021	Cuestionable	2.0 < IZI < 3.0
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 0	Insatisfactorio	IZI >= 3.0

Observaciones

Específicas :

Generales : Se recomienda informar adecuadamente los métodos en uso. Nosotros no efectuamos correcciones al respecto. Esto puede ocasionarles resultados insatisfactorios en su desempeño. La información correspondiente a cada método aparece claramente señalada en los respectivos insertos de los proveedores de los kits comerciales.

La información contenida en este informe se considera confidencial, salvo las contempladas en la ley vigente.



Autorizado por:

BQ. PAOLA PELLEGRINI PINTO
JEFA SECCIÓN QUÍMICA CLÍNICA